



WebReq 3

Release notes d. 29.10.2024

INDHOLD

1	WEBREQ	3
1.1	TOMME REKVISITIONER IFM. EGNE ANALYSER (WR-1240)	3
1.2	SYSTEMFEJL VED AUTOOPRETTELSE AF PATIENTER UDEN REGION (WR-1243).....	3
1.3	FORBEDRINGER PÅ MOBILLAB (WR-1244 OG WR-1254)	3
1.4	VED MAPNING AF ANALYSE, SKRIVES DER NU KUN ÉN BLANKET UD (WR-1250)	4
1.5	PATOLOGI: VALIDERING PÅ FELTET BESKRIVELSE (WR-1251)	4
1.6	LODRET GLASNR. PÅ PRØVETAGNINGSBANKET FORBEDRET (WR-1253)	4
1.7	DATABEHANDLERAFKALE KAN NU PRINTES (PLATFORM-542)	5
1.8	TEKSTÆNDRING VED DATABEHANDLERAFKALE DER IKKE ER GODKENDT INDEN UDLØB (WR-615).....	5
1.9	FILTRERING AF PATIENT SPECIFIKKE LABORATORIEPROFILER (WR-1248).....	6
1.10	TILFØJELSE AF MAX ANTAL TEGN FOR PROFILER (WR-1262)	6

1 WebReq

1.1 Tomme rekvisitioner ifm. egne analyser (WR-1240)

"Tomme rekvisitioner" blev set på laboratoriet, hvis en prøvetagningsblanket kun indeholdte "Egne analyser" og klinikken var sat til "Send straks" i rekvirentopsætningen

Dette er rettet, så "Egne analyser" ikke kommer ind, uanset om der er sat flueben eller ej.

☒ Fjern rettighed for at rette rekvisition. (Rekvisition sendes straks)

1.2 Systemfejl ved autooprettelse af patienter uden region (WR-1243)

Når lægesystemet ikke får medsendt feltet "Region" til WebReq, vil der nu ikke længere blive vist en fejl. Patienten vil kunne indlæses.

1.3 Forbedringer på mobillab (WR-1244 og WR-1254)

Hvis et laboratorium har fravalgt mobillab, så ses der for rekvirenterne ikke noget laboratorium.

Har klinikken behov for at bestille til et andet laboratorium, gøres det under **Vælg en rute**, hvorefter analyser kan vælges til det angivne laboratorium.

Hvis en klinik har fået bestilt prøver under rekvisitionstypen "**Klinik analyser**" i stedet for "**Mobillab**" men har angivet data under "**Vælg en rute**" ses denne besked i Bestillingslisten:

1.4 Ved mapning af analyse, skrives der nu kun én blanket ud (WR-1250)

Er en analyse sat til at kunne mappes over fra andre lab. vil alle analyser på rekvisitionen komme på samme prøvetagningsblanket

Andre koder, der skal mappes over til denne analyse fra andre lab.

1.5 Patologi: Validering på feltet beskrivelse (WR-1251)

Der er sat validering på de Patologi **Typer** der har feltet **Beskrivelse**, så der kun kan skrives 70 tegn.

Favoritter		KBA	MIK	PAT	Tlf. 35455483	
Typer				Materialer		
☐	Cervixcytologi			1		Beskrivelse
☒	Histologi			2		
☐	Anden cytologi					

1.6 Lodret glasnr. på prøvetagningsblanket forbedret (WR-1253)


Det glas nummer der står øverst (lodret) på strejkodeetiketten, er forbedret, så det ikke går ud over etiketten og vises på naboetiketten. Nummeret ses kun ved udskriftskoden: **Labka 2**



Labka2 (teksten hentes fra glasgruppenavn og glasnummer skrives lodret)

1.7 Databehandleraftale kan nu printes (platform-542)

Print af databehandleraftale kan gøres under **"initialerne/navn"** for den ansvarlige læge → **Aftaler** → **printer ikon**

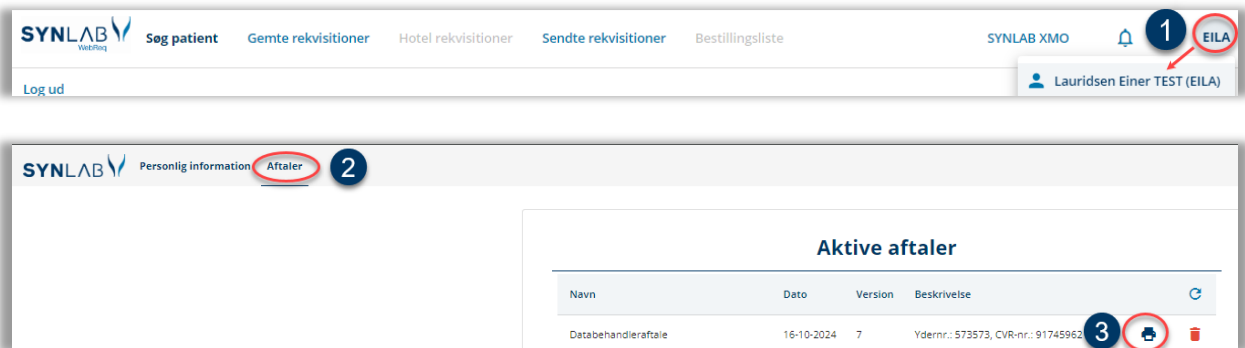

Print er også mulig, når man er inde for at godkende databehandleraftalen:



1.8 Tekstændring ved Databehandleraftale der ikke er godkendt inden udløb (WR-615)

Er en Databehandleraftale ikke godkendt inden udløb (14 dage) vises nu flg. Tekst for klinikken:

"Vi mangler din godkendelse af Databehandleraftalen"

Tryk på "Fortsæt" knappen for at godkende databehandleraftalen for derefter at returnere til Webreq"



1.9 Filtrering af patient specifikke laboratorieprofiler (WR-1248)

Hvis laboratoriet ved et tilfælde, skulle have oprettet en **Patientsspecifik Laboratorieprofil**, vil den blive vist med **fed** øverst i listen og kun når patienten er angivet i WebReq.



1.10 Tilføjelse af max antal tegn for profiler (WR-1262)

Følgende begrænsninger er sat på profiler:

Profilnavn: max 200 tegn

Profilinfo: max 80 tegn

